




<使用までのスケジュール>

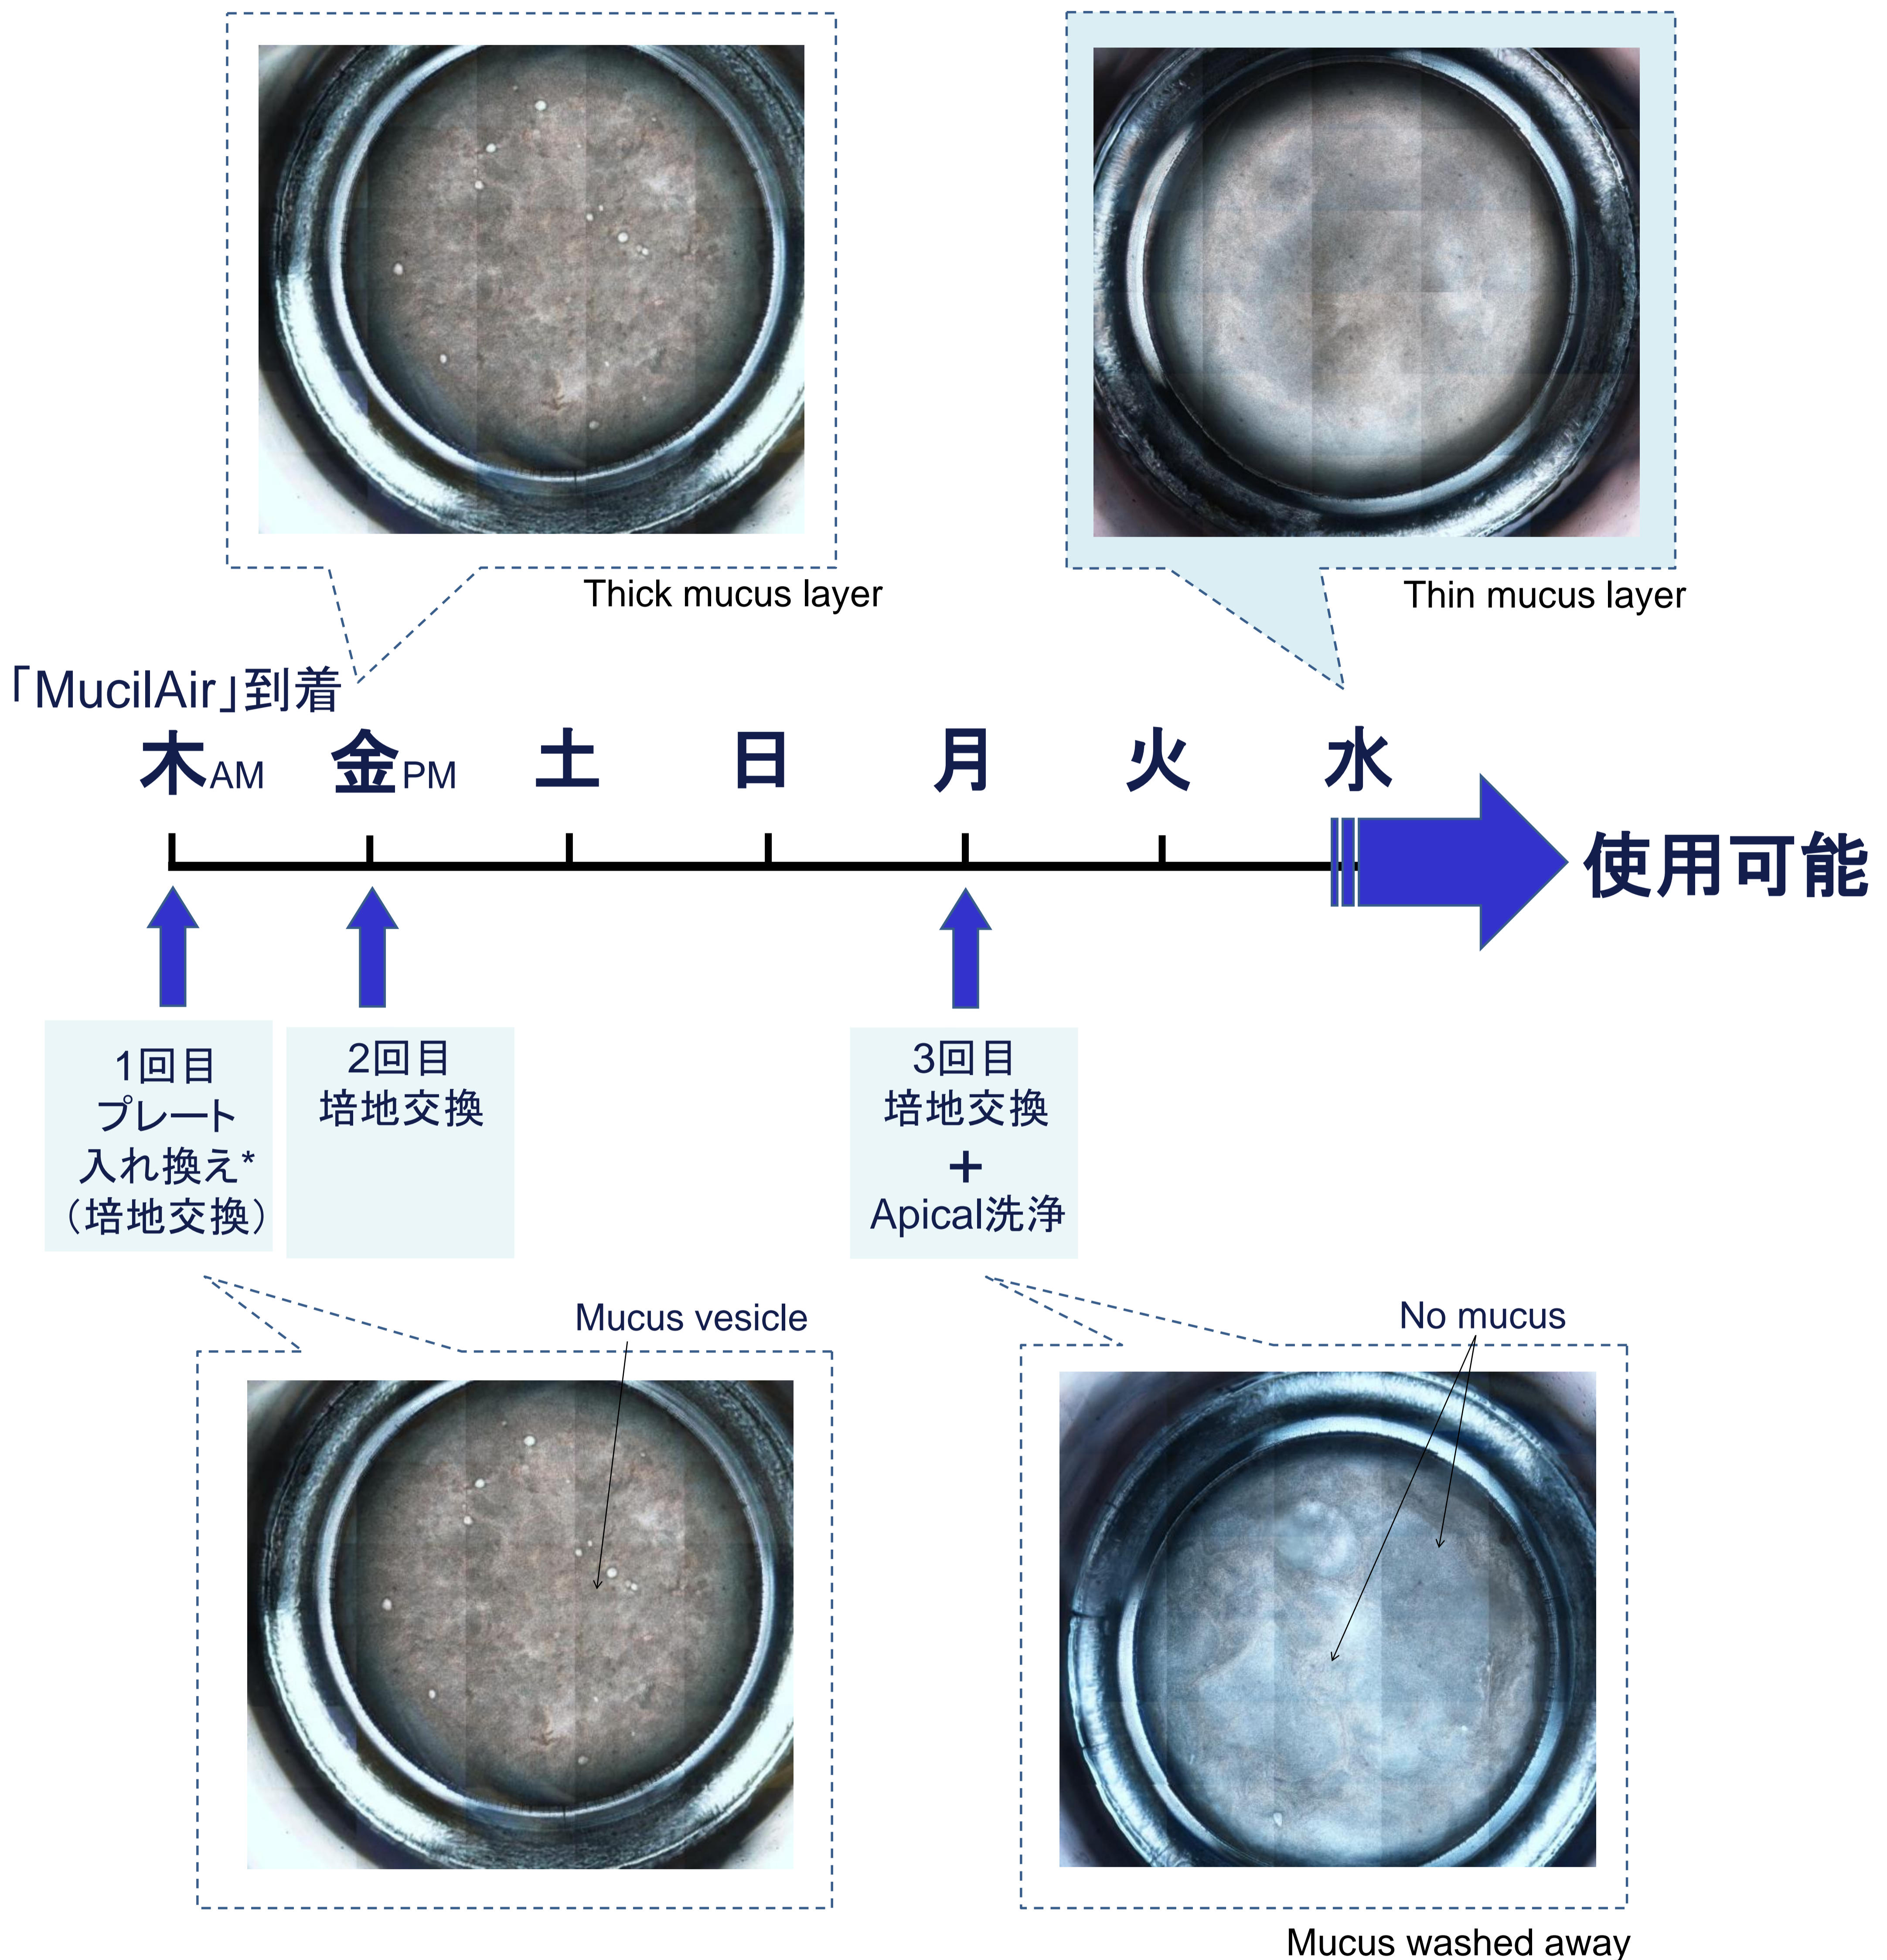

*Corning社24ウェルプレート(Costar Plate#3526)を予め準備してください。

【3回目培地交換とApical洗浄後、実験せずに培養を継続する場合】

- ・「MucilAir用培養液」による培地交換を2-3日毎に行ってください。
- ・「MucilAir用培養液」によるApical洗浄を2週間毎に行ってください。
- ・プレート交換を1ヶ月毎に行ってください。